




Datenblatt

Belastungseinrichtung für Zeitstandversuch

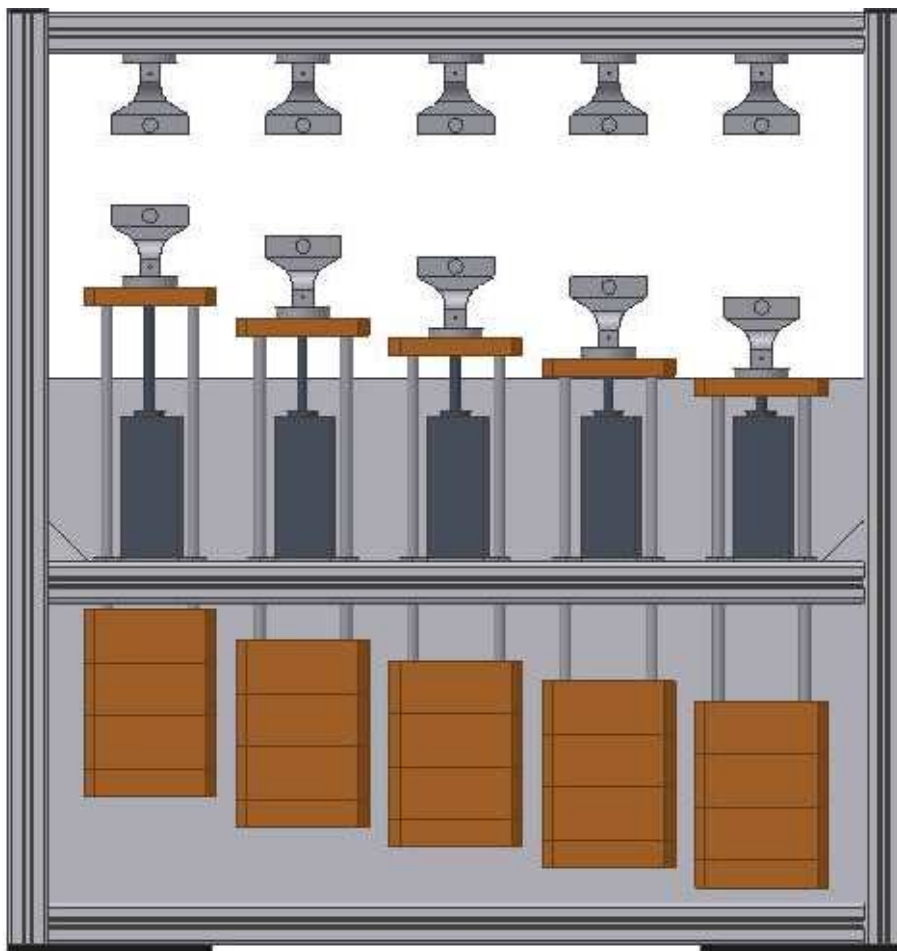

bestehend aus:

- Rahmengerüst zur Aufnahme von 5 Belastungseinrichtungen
- Lastaufbringung über Gewichte
- wirkende Kraft je 50 bis 200 N an jeder Belastungseinrichtung
- Genauigkeit der wirkenden Kraft +/- 1 % der Endkraft von 50 bis 200 N
- die einzelnen Belastungseinrichtungen sind mechanisch entkoppelt, um Schwingungen beim Probenbruch zu vermeiden
- 5 Probenhalterungen für Textilproben